



PocketE

Caméra thermique
Manuel d'utilisation



Nous contacter

CONSIGNES DE SECURITE

L'objectif de ces instructions est de garantir que l'utilisateur soit en mesure d'utiliser correctement le produit sans danger ou dommage aux biens. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Lois et réglementations

L'appareil doit être strictement utilisé conformément à la réglementation locale en matière de sécurité électrique.

Transport

- ◆ Gardez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire lors de son transport.
- ◆ Veuillez conserver l'emballage de l'appareil pour toute utilisation ultérieure. En cas de panne, vous devrez renvoyer l'appareil à l'usine dans son emballage d'origine. Le transport de l'appareil sans son emballage d'origine peut l'endommager, et l'entreprise se dégage de toute responsabilité dans ce cas.
- ◆ Ne pas faire tomber le produit ou le soumettre à un choc physique. Éloigner l'appareil d'interférences magnétiques.

Alimentation électrique

- ◆ La tension d'entrée doit répondre aux exigences relatives à une Source d'alimentation limitée (3,85 VCC, 570 mA) conformément à la norme CEI 62368. Veuillez vous référer aux caractéristiques techniques pour des informations détaillées.
- ◆ Vérifiez que la prise est correctement branchée à la prise électrique.
- ◆ Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie dû à une surcharge, ne reliez PAS plusieurs appareils à un seul adaptateur d'alimentation.
- ◆ Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en matière d'alimentation.

Batterie

- ◆ ATTENTION : Il y a un risque d'explosion lorsque la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Remplacez-les uniquement par une pile/des batteries identiques ou de type équivalent. Éliminez les piles/batteries usées conformément aux instructions fournies par leur fabricant.
- ◆ Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- ◆ Ne jetez pas une pile au feu ou dans un four chaud, ni ne broyez mécaniquement ou découpez une pile, car cela pourrait engendrer une explosion.
- ◆ Ne laissez pas une pile dans un environnement ambiant extrêmement chaud, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- ◆ N'exposez pas une pile à des pressions atmosphériques extrêmement basses, car vous

encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

- ◆ Éliminez les piles/batteries usées conformément aux instructions fournies par leur fabricant.
- ◆ La batterie intégrée ne peut pas être démontée. Veuillez contacter le fabricant pour réparation si nécessaire.
- ◆ Pour le stockage à long terme de la pile, assurez-vous qu'elle est complètement chargée tous les trois mois afin d'en garantir la qualité. Dans le cas contraire, elle pourrait se détériorer.
- ◆ Utilisez une batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les détails concernant la pile.
- ◆ NE chargez pas d'autres types de piles avec le chargeur fourni. Pendant la recharge des batteries, vérifiez qu'il n'y a aucun matériau inflammable à moins de 2 m du chargeur.
- ◆ Lorsque l'appareil est éteint et que la batterie RTC est complètement chargée, les réglages de l'heure peuvent être conservés pendant 6 mois.
- ◆ Lors de la première utilisation, chargez l'appareil pendant plus de 3 heures lorsqu'il est éteint.
- ◆ La tension de la batterie au lithium est de 3,85 V et sa capacité est de 2 100 mA h.
- ◆ La batterie est certifiée conforme à la norme UL2054.

Maintenance

- ◆ NE maintenez PAS l'appareil lorsqu'il est sous tension, car cela pourrait causer une électrocution ! Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche. Nous n'assumerons aucune responsabilité concernant les problèmes causés par une réparation ou une opération de maintenance non autorisée.
- ◆ Essuyez délicatement l'appareil à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'une petite quantité d'éthanol, si nécessaire.
- ◆ Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux indications du fabricant, le dispositif de protection fourni par l'appareil peut être compromis.
- ◆ Sachez que la limite actuelle du port USB 3.0 PowerShare peut varier selon la marque de l'ordinateur. C'est pourquoi un problème d'incompatibilité peut survenir. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser un port USB 3.0 ou USB 2.0 standard si le périphérique USB n'est pas reconnu par le PC via le port USB 3.0 PowerShare.
- ◆ Votre caméra effectue automatiquement et régulièrement un étalonnage pour optimiser la qualité des images et la précision des mesures. Pendant cette opération, l'image s'interrompt brièvement et vous entendez un déclic lorsque l'obturateur s'ouvre devant le détecteur. L'étalonnage automatique est plus fréquent au démarrage ou dans des environnements très froids ou chauds. Ce comportement est normal et permet de garantir des performances optimales de votre caméra.

Environnement d'exploitation

- ◆ Assurez-vous que l'environnement d'exploitation répond aux exigences de l'appareil. La température de fonctionnement doit être comprise entre -10 °C et 50 °C, et l'humidité de fonctionnement doit être de 95 % ou moins.

- ◆ Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
- ◆ N'exposez PAS l'appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques ou à des environnements poussiéreux.
- ◆ N'orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive.
- ◆ Pendant l'utilisation de tout équipement générant un laser, veillez à ce que l'objectif de l'appareil ne soit pas exposé au faisceau laser, car il pourrait brûler.
- ◆ N'orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive.
- ◆ L'appareil convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur, mais ne l'exposez pas à l'humidité.
- ◆ Le niveau de protection est IP 54.
- ◆ L'appareil est uniquement destiné à un usage en intérieur.

Urgence

- ◆ Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s'échappent de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez un centre de réparation.

Services d'étalonnage

- ◆ Veuillez contacter le revendeur local pour obtenir des informations sur les points d'entretien. Pour des services d'étalonnage plus détaillés, veuillez visiter le site Internet <https://www.hikmicrotech.com/en/support/>.

Assistance technique

- ◆ Le portail <https://www.hikmicrotech.com/en/contact-us.html> vous aidera en tant que client HIKMICRO, à tirer le meilleur parti de vos produits HIKMICRO. Depuis le portail, accédez à notre équipe d'assistance, à des logiciels et de la documentation, à des contacts en rapport avec le support, etc.

GARANTIE LIMITÉE

Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie du produit.



Adresse de fabrication

Logement 313, Unité B, Bâtiment 2, 399 Danfeng Road, Sous-district de Xixing, District de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Chine

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVIS DE CONFORMITÉ

il est possible que les produits de la série thermique soient soumis à des contrôles d'exportation dans divers pays ou diverses régions, ce qui inclut, sans s'y limiter, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni ou d'autres pays membres de l'Arrangement de Wassenaar. Veuillez consulter votre expert professionnel en questions juridiques ou en conformité ou les autorités de votre gouvernement local pour toute exigence de permis d'exportation si vous prévoyez de transférer, d'exporter ou de réexporter des produits de la série thermique entre différents pays.

Conventions des symboles

Les symboles que vous pouvez rencontrer dans ce document sont définis comme suit.

<i>Symbole</i>	<i>Description</i>
 Danger	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînerait la mort ou provoquerait de graves blessures.
 Mise en garde	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourra entraîner des dommages de l'équipement, des pertes de données, une dégradation des performances ou des résultats imprévisibles.
 Remarque	Fournit des informations supplémentaires pour souligner ou compléter des points importants du texte principal.

CONTENU

Chapitre 1 Vue d'ensemble	1
1.1 Avis à l'utilisateur.....	1
1.2 Description de l'appareil	1
1.3 Fonction principale.....	1
1.4 Apparence	2
Chapitre 2 Préparation	4
2.1 Chargement de l'appareil.....	4
2.2 Allumer/éteindre.....	4
2.2.1 Réglage de la durée de mise hors tension automatique.....	4
2.3 Méthode de fonctionnement	5
2.4 Menus et opérations	5
Chapitre 3 Commencez avec le Mode scène	7
3.1 Sélectionnez un Mode scène	7
3.2 (Facultatif) Définissez les paramètres du mode scène	9
Chapitre 4 Mesure précise de la température	11
4.1 Définissez les paramètres de mesure de la température	11
4.1.1 Ajustez la distance	11
4.1.2 Ajustez l'émissivité.....	11
4.1.3 (Facultatif) Ajustez Autres paramètres	12
4.2 Réglage des outils de mesure	12
4.3 Effacez tous les outils de mesure.....	12
Chapitre 5 (Facultatif) Définissez l'alarme	14
Chapitre 6 Paramètres d'affichage	15
6.1 Réglage de la luminosité de l'écran	15
6.2 Définir SuperIR.....	15
6.3 Réglage du mode d'image	15
6.4 Réglage du niveau et de la portée.....	16
6.5 Réglage des informations affichées à l'écran.....	17

Chapitre 7 Image et vidéo	18
7.1 Capturer une image	18
7.2 Enregistrement d'une vidéo	19
7.3 Gestion des albums	19
7.4 Affichage de fichiers	20
7.5 Gestion des fichiers	20
7.6 Exportation des fichiers	22
7.6.1 Exporter via HIKMICRO Viewer	22
7.6.2 Exportation via l'ordinateur	22
Chapitre 8 Connexions de l'appareil	23
8.1 Diffuser l'écran de l'appareil sur l'ordinateur	23
8.2 Connectez l'appareil à HIKMICRO Viewer	23
8.2.1 Connexion via Wi-Fi	23
8.2.2 Connexion via point d'accès	24
Chapitre 9 Paramètres système	26
9.1 Configurer l'heure et la date	26
9.2 Définir les unités de mesure	26
9.3 Réglage de la langue	26
Chapitre 10 Maintenance	27
10.1 Affichage des informations sur l'appareil	27
10.2 Mise à niveau de l'appareil	27
10.2.1 Mettre à niveau l'appareil via le fichier de mise à niveau	27
10.2.2 Mise à niveau de l'appareil à l'aide de HIKMICRO Viewer	27
10.3 Restaurer l'appareil	27
10.4 Enregistrer les journaux des opérations	28
10.5 Initialisation du stockage	28
10.6 À propos de l'étalonnage	28
Chapitre 11 Questions fréquentes	29

CHAPITRE 1 VUE D'ENSEMBLE

1.1 Avis à l'utilisateur

Ce manuel décrit et explique les fonctionnalités de plusieurs modèles de caméras. Les modèles de caméra d'une série ayant des fonctionnalités différentes, ce manuel contient des descriptions et des explications qui ne s'appliquent pas à votre modèle de caméra particulier.

Les modèles de caméra d'une série ne prennent pas tous en charge les applications mobiles, les logiciels et toutes les fonctions de ceux-ci mentionnées ou non dans ce manuel. Pour obtenir des instructions plus détaillées, reportez-vous aux manuels d'utilisation de l'application et des logiciels.

Ce manuel est régulièrement mis à jour. Cela signifie que ce manuel peut ne pas contenir les informations relatives aux nouvelles fonctionnalités des micrologiciels, clients mobiles et logiciels les plus récents.

1.2 Description de l'appareil

La caméra thermographique Pocket est un appareil produisant des images optiques et des images thermiques. Elle peut mesurer les températures, enregistrer des vidéos, prendre des instantanés et déclencher des alarmes.

Avec sa fonction Wi-Fi/point d'accès, elle peut fonctionner avec les applications de votre téléphone.

La caméra, simple d'utilisation, adopte un design ergonomique. Il est largement utilisé pour inspecter des immeubles, un système de climatisation (HVAC) ainsi que pour la maintenance d'équipement électrique et mécanique.

1.3 Fonction principale

SuperIR

La caméra prend en charge SuperIR pour améliorer les contours des objets. Certains modèles de caméra peuvent afficher une image SuperIR en temps réel dans la vue en direct

Mode scène

La caméra prend en charge plusieurs modes de scène pour différentes cibles de détection et scénarios. Certains modes scène prennent en charge SuperScene, une fonction intelligente. Il peut aider à la détection des anomalies et donner des conseils en plus de l'interface de vue en direct.

Mesure de la température

La caméra détecte et affiche la température en temps réel.

Mode d'image

La caméra peut afficher la vue thermique et/ou la vue optique. Vous avez le choix entre Thermique, Fusion, PIP, Mixte et Optique

Palettes

La caméra prend en charge plusieurs palettes de couleurs pour des cibles et des préférences utilisateur différentes.


Connexion de logiciel client



Scannez le code QR pour télécharger l'application HIKMICRO Viewer, afin d'utiliser la vue en direct, capturer des instantanés, enregistrer des vidéos, etc.

Téléchargez HIKMICRO Analyzer (<https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/hikmicro-analyzer-software.html>) pour analyser les fichiers.

1.4 Apparence

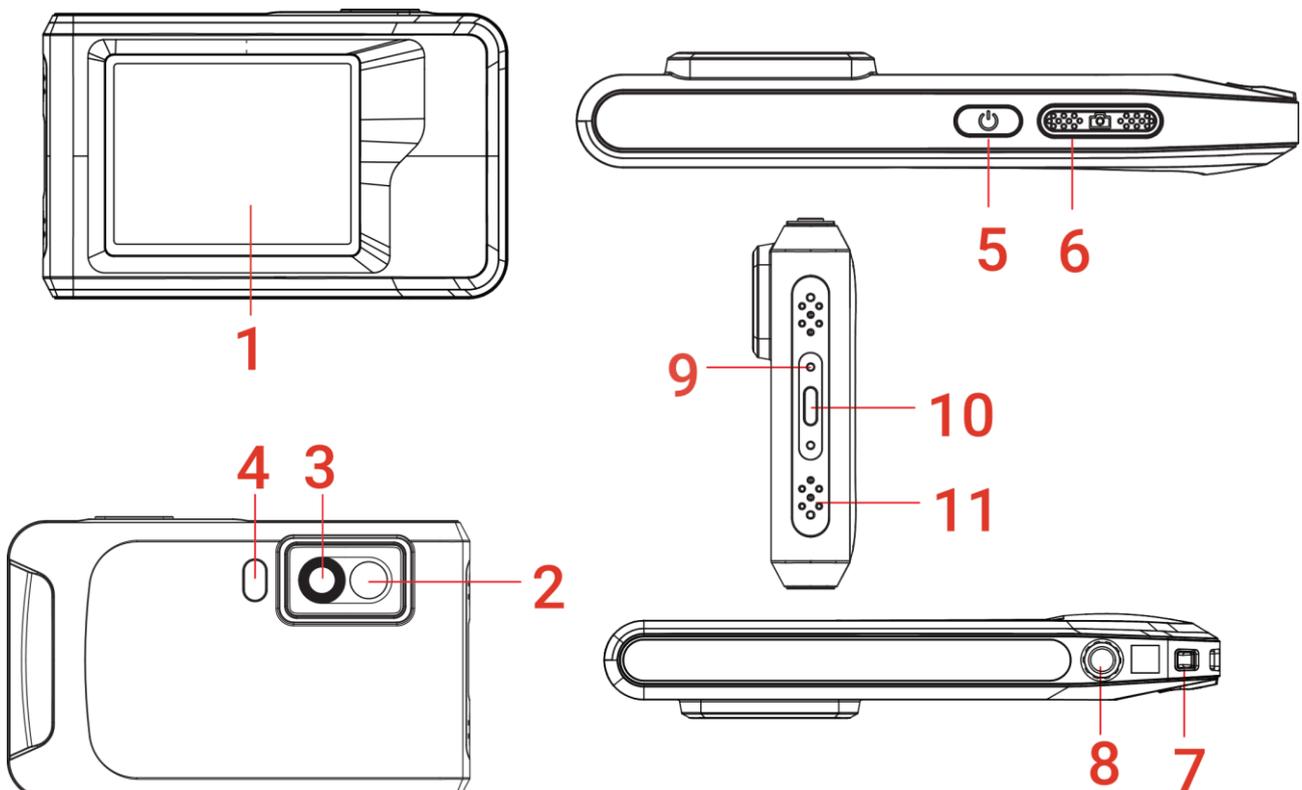

N°	Description	Fonction
1	Écran de contrôle tactile	Affichage des images et utilisation de l'appareil à l'aide de commandes tactiles.
2	Objectif optique	Observer l'image visuelle.
3	Objectif thermique	Observer l'image thermique.
4	Voyant clignotant	Diriger la lumière sur les objets et émettre une alarme clignotante.
5	Touche Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Maintenir enfoncé : Marche/arrêt de l'appareil. ◆ Appuyer : Mise en veille/Réactivation manuelle de l'appareil
6	Touche Capturer	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Appuyer brièvement pour capturer une image. ◆ Maintenir la touche enfoncée pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo et appuyer sur la touche à nouveau pour l'arrêter.
7	Point de fixation de la bride	Monter la dragonne.
8	Fixation pour trépied	Permet de monter un trépied.
9	Indicateur de chargement	<p>Indique l'état de charge de l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rouge fixe : charge normale ◆ Rouge clignotant : charge anormale ◆ Vert fixe : charge complète
10	Interface de type C	Pour recharger l'appareil ou exporter des fichiers à l'aide du câble USB fourni.
11	Microphone	Enregistrer l'audio.

**REMARQUE**

Votre caméra effectue automatiquement et régulièrement un étalonnage pour optimiser la qualité des images et la précision des mesures. Pendant cette opération, l'image s'interrompt brièvement et vous entendez un déclic lorsque l'obturateur s'ouvre devant le détecteur. Le message "Étalonnage de l'image..." apparaît dans la partie supérieure centrale de l'écran pendant que l'appareil s'étalonne. L'étalonnage automatique est plus fréquent au démarrage ou dans des environnements très froids ou chauds. Ce comportement est normal et permet de garantir des performances optimales de votre caméra.

CHAPITRE 2 PREPARATION

2.1 Chargement de l'appareil

La caméra est équipée d'une batterie. Il est recommandé de charger la caméra avec le câble USB inclus et l'interface de type C sur la caméra. N'utilisez pas de câble USB-C vers USB-C d'un autre fabricant. L'adaptateur d'alimentation (non inclus) doit être conforme aux normes suivantes :

- ◆ Tension/Courant de sortie : 5 V CC/2 A
- ◆ Sortie d'alimentation minimale : 10 W

Vérifiez le témoin d'alimentation pour connaître l'état de charge :

- ◆ Rouge fixe : charge normale
- ◆ Rouge clignotant : charge anormale
- ◆ Vert fixe : charge complète



REMARQUE

- ◆ La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 8 watts minimum requis par l'équipement radio et 10 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- ◆ Si vous n'utilisez pas la caméra pendant une période prolongée et qu'elle est complètement déchargée, il est recommandé de la charger pendant au moins 30 minutes avant de la mettre sous tension.
- ◆ Il est recommandé d'utiliser le câble USB inclus dans l'emballage pour la charge et le transfert des données.

2.2 Allumer/éteindre

Allumer

Maintenez le bouton  enfoncé pendant plus de trois secondes pour allumer l'appareil. Vous pouvez observer la cible lorsque l'interface de l'appareil est stable.



REMARQUE

Lorsque vous allumez l'appareil, cela peut prendre au moins 6 secondes jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé.

Éteindre

Une fois l'appareil allumé, maintenez la touche  enfoncée pendant environ trois secondes pour l'éteindre.

2.2.1 Réglage de la durée de mise hors tension automatique


Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de l'appareil > Mise hors tension automatique** pour définir l'heure d'arrêt automatique de l'appareil selon les besoins.

2.3 Méthode de fonctionnement

L'appareil prend également en charge le contrôle par écran tactile. Vous pouvez toucher l'écran pour utiliser l'appareil.

2.4 Menus et opérations


Vue en direct

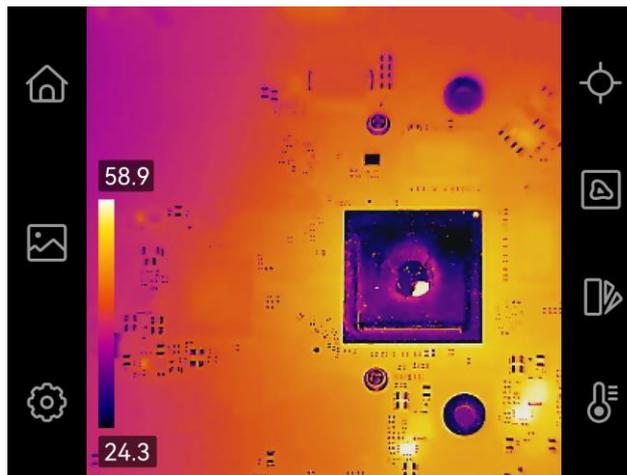

<i>Icône</i>	<i>Description</i>
	Revenez à l'interface de vue en direct.
	Accéder aux albums pour afficher les images et les vidéos capturées. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à 7.3 Gestion des albums .
	Régler les paramètres locaux de l'appareil.
	Activer/désactiver les outils de mesure. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à 4.2 Réglage des outils de mesure .
	Changement du mode d'image : thermique, optique, fusion, etc. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à 6.3 Réglage du mode d'image .
	Changement de palette de couleurs de l'image thermique. Vous pouvez changer rapidement de palette via MENU > Palettes .
	Réglez le niveau et portée pour l'affichage de l'image thermique. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à 6.4 Réglage du niveau et de la portée .

Menu déroulant

Dans l'interface de vue en direct, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher le menu déroulant. Ce menu permet d'activer/désactiver les fonctions de l'appareil, de modifier le thème d'affichage et de régler la luminosité de l'écran.

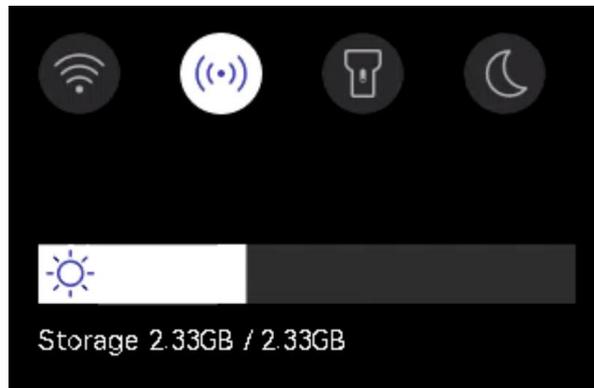

<i> Icône </i>	<i> Description </i>
	Activation/désactivation du Wi-Fi. Pour obtenir des instructions sur la configuration du Wi-Fi, reportez-vous à <i>8.2.1 Connexion via Wi-Fi</i> .
	Activation/désactivation du point d'accès. Pour obtenir des instructions sur la configuration du point d'accès, reportez-vous à <i>8.2.2 Connexion via point d'accès</i> .
	Activation/désactivation de l'éclairage LED.
	Changement de thème. Le mode jour ou nuit est pris en charge.
	Réglage de la luminosité de l'écran.

CHAPITRE 3 COMMENCEZ AVEC LE MODE SCÈNE

Pour effectuer une détection rapide des anomalies, plusieurs modèles prédéfinis sont inclus dans le mode **Scène** pour différents scénarios de détection. Les utilisateurs peuvent choisir une scène appropriée ou personnaliser une scène en fonction des cibles et définir des alarmes de température élevée selon les besoins.

1. Sélectionnez un Mode scène approprié. Voir *3.1 Sélectionnez un Mode scène* pour plus de détails.
2. (Facultatif) Ajustez les paramètres du Mode scène selon vos besoins. Voir *3.2 (Facultatif) Définissez les paramètres du mode scène* pour plus de détails.
3. (Facultatif) Définissez des alarmes selon vos besoins. Voir *Chapitre 5 (Facultatif) Définissez l'alarme* pour plus de détails.
4. Observez les résultats de détection dans l'interface de vue en direct.

3.1 Sélectionnez un Mode scène

En mode vue en direct, appuyez sur  > **Scène** pour choisir un mode scène approprié.

REMARQUE

La valeur par défaut des paramètres fonctionne dans la plupart des cas. Si les utilisateurs souhaitent affiner les paramètres associés selon leurs besoins, veuillez vous référer à 3.2 (Facultatif) Définissez les paramètres du mode scène.

Fuite d'eau

Pour inspecter les fuites d'eau des plafonds, des murs et des planchers des bâtiments à l'intérieur.

La technologie SuperScene peut aider à reconnaître rapidement les anomalies lors de la détection des fuites d'eau. Quand **SuperScène** est activé et les anomalies de fuite d'eau sont détectées, *Suspect* sera affiché en haut de la vue en direct.


**REMARQUE**

- ◆ Des rapports manqués ou même erronés apparaissent lorsque la différence de température des zones présentant des anomalies de fuite est trop subtile pour être reconnue, etc.
- ◆ Il est recommandé de donner un deuxième diagnostic basé sur la fonction SuperScene. L'algorithme de la fonction SuperScene est en cours de mise à jour.
- ◆ Le changement de mode d'image n'est pas pris en charge dans ce mode.

Isolation

Pour détecter les déficiences d'isolation intérieure des murs et des plafonds des bâtiments, les utilisateurs courants peuvent appliquer cette scène.

La technologie SuperScene peut aider à reconnaître rapidement les anomalies lors de la détection de l'isolation. Quand **SuperScène** est activé et les anomalies d'isolation sont détectées, *Suspect* sera affiché en haut de la vue en direct.

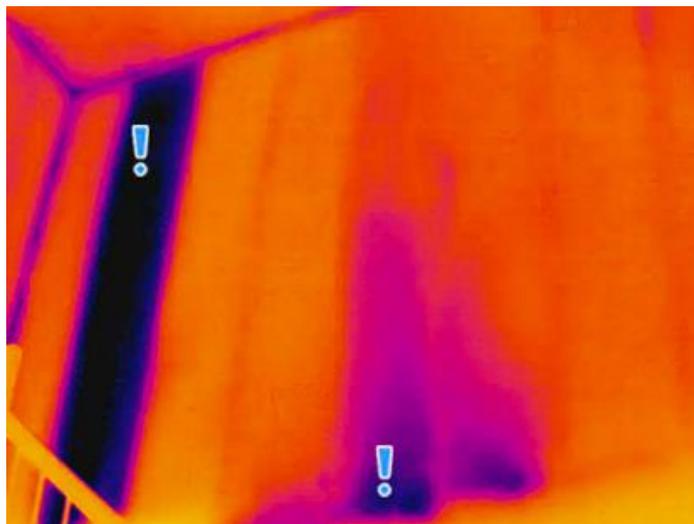

**REMARQUE**

- ◆ Des rapports manqués ou même erronés apparaissent lorsque la différence de température des zones présentant des anomalies de fuite est trop subtile pour être reconnue, etc.
- ◆ Il est recommandé de donner un deuxième diagnostic basé sur la fonction SuperScene. L'algorithme de la fonction SuperScene est en cours de mise à jour.
- ◆ Le changement de mode d'image n'est pas pris en charge dans ce mode.

Ch. Planch

Pour détecter et observer les défauts du système de chauffage plancher.

Défauc élec

Pour détecter et observer les défauts des fils, des circuits, des composants électriques, des terminateurs, etc.

Panneau solaire

Pour détecter et observer les défauts des panneaux solaires.

Personnaliser

Les utilisateurs peuvent personnaliser un mode pour enregistrer les paramètres de mesure de température souhaités pour une utilisation ultérieure. Reportez-vous à 3.2 (Facultatif) *Définissez les paramètres du mode scène.*

3.2 (Facultatif) Définissez les paramètres du mode scène

Pour obtenir des résultats de détection plus précis, les utilisateurs peuvent affiner les paramètres associés via  > **Scène**.

**REMARQUE**

Les paramètres varient selon les différentes scènes.

<i>Paramètres</i>	<i>Description</i>
Émissivité	Réglez l'émissivité en fonction de votre cible.
Palettes	Les imageries thermiques sont créées par la différence de température. Les palettes sont des couleurs représentant la température. Les utilisateurs peuvent choisir une palette en fonction de leurs couleurs préférées. L'échelle de température sur la gauche permet de parcourir la relation couleur-température dans l'image. Reportez-vous à 6.4 <i>Réglage du niveau et de la portée.</i>
Plage températures	de Sélectionnez la plage de mesure de la température. L'appareil peut détecter la température et commuter automatiquement la

plage de mesure des températures en mode **Changement automatique**.

Alarme

Lorsque la température des cibles déclenche la règle d'alarme définie, les utilisateurs peuvent être avertis de la manière définie. Voir *Chapitre 5 (Facultatif) Définissez l'alarme*.

Distribution des couleurs

des Linéaire et Histogramme les modes sont sélectionnables pour différentes scènes d'application, afin d'afficher plus de détails.

- ◆ **Linéaire** : Détectez les petites cibles à haute température dans un arrière-plan à basse température pour améliorer et afficher plus de détails sur les cibles à haute température, telles que les connecteurs de câbles.
- ◆ **Histogramme** : Détectez les petites cibles à basse température dans les zones à haute température pour améliorer la différence de température et conserver les détails des objets à basse température, tels que les fissures.

CHAPITRE 4 MESURE PRECISE DE LA TEMPERATURE

Pour obtenir une température plus précise et en temps réel de la cible, l'utilisateur peut définir des outils ponctuels et une alarme de température élevée selon les besoins.

1. Sélectionnez une scène appropriée pour accélérer les paramètres de mesure. Voir *Chapitre 3 Commencez avec le Mode scène*.
2. Vérifiez les valeurs de température dans le coin supérieur gauche de la vue en direct. S'ils ne sont pas suffisamment précis, affinez les paramètres de mesure de la température. Reportez-vous à *4.1 Définissez les paramètres de mesure de la température*.
3. Définissez des outils ponctuels pour obtenir la température en temps réel du point de température le plus élevé/le plus bas/le centre. Reportez-vous à *4.2 Réglage des outils de mesure*.
4. (Facultatif) Réglez l'alarme pour les cibles à température élevée. Reportez-vous à *Chapitre 5 (Facultatif) Définissez l'alarme*.
5. Observez les résultats de température dans l'interface de vue en direct.

4.1 Définissez les paramètres de mesure de la température

4.1.1 Ajustez la distance

La distance entre la caméra et la cible d'observation affecte la précision des résultats de température. Avant de mesurer la température, les utilisateurs doivent d'abord définir la distance.

Si les utilisateurs souhaitent un modèle prédéfini en fonction de la distance approximative entre la caméra et la cible, les modes **Près/Milieu/Loin** sont disponibles.

Si les utilisateurs souhaitent des résultats plus précis, le mode **Personnalisé** est disponible.

1. En mode vue en direct, appuyez sur  > **Paramètres de mesure de température** > **Distance**.
2. Choisissez un mode de distance.



REMARQUE

Les utilisateurs peuvent régler rapidement la distance de mesure de la température en vue en direct en faisant défiler la molette de distance.

4.1.2 Ajustez l'émissivité

L'émissivité affecte directement la précision de la mesure et doit être réajustée en fonction des caractéristiques du matériau cible.

1. Aller à  > **Scène** pour sélectionner une scène.
2. Dans l'interface de configuration de la scène, choisissez une valeur recommandée ou personnalisez-la.
3. Appuyez sur  pour enregistrer et sortir des réglages.

4.1.3 (Facultatif) Ajustez Autres paramètres

Pour améliorer la précision de la mesure de la température, ajustez les paramètres de mesure de la température via  > **Paramètres de mesure de la température**.

Paramètres	Description
Température réfléchie	Si un objet (autre que la cible) à température élevée se trouve dans la scène et que l'émissivité de la cible est faible, définissez la température de réflexion comme température élevée pour corriger l'effet thermographique. Reglez Température réfléchie comme valeur de l'objet à haute température pour annuler l'interférence.
Humidité	Définissez l'humidité de l'environnement actuel dans lequel se trouve la caméra.

4.2 Réglage des outils de mesure

Définissez les outils de mesure pour mesurer les températures minimale, maximale et centrale de la scène actuelle.

1. Appuyez sur  dans la vue en direct.
2. Appuyez pour sélectionner l'outil de mesure de la température selon les besoins. Vous avez le choix entre **Chaud** , **Froid** , et **Centre** .
3. Appuyez n'importe où sur l'écran pour enregistrer et quitter.



REMARQUE

- ◆ Les températures minimale, maximale et centrale sont affichées dans la partie supérieure gauche de l'écran. Appuyez de nouveau sur l'outil pour le supprimer.
- ◆ S'il y a une inexactitude grave dans les résultats de température, éteignez le bouton **SuperTemp** en allant à  > **Paramètres de mesure de la température** > **SuperTemp**. SEULS certains modèles prennent en charge la fonction SuperTemp.

4.3 Effacez tous les outils de mesure

Les utilisateurs peuvent effacer tous les outils de mesure définis via  > **Paramètres de l'appareil** > **Initialisation de l'appareil** > **Supprimer tous les outils de mesure**. Et une fenêtre

apparaît pour vous demander **Réglage réussi**.



REMARQUE

La palette est également restaurée aux paramètres par défaut.

CHAPITRE 5 (FACULTATIF) DEFINISSEZ L'ALARME

Lorsque la température des cibles déclenche la règle d'alarme haute définie, l'appareil effectue les actions configurées, telles que l'émission d'une alarme auditive et le déclenchement de l'alarme flash.

1. Sélectionnez un Mode scène via  > **Scène**.
2. Dans l'interface de configuration de la **Scène**, appuyez sur **Alarme** pour accéder à l'interface des **Régl alarm**.

**REMARQUE**

SEULES certaines scènes prennent en charge l'alarme. Veuillez vous référer à l'appareil réel.

3. Activez l'**Alarme de température**.
4. Appuyez sur **Seuil d'alarme** pour définir les limites supérieures de température en faisant défiler la molette.
5. Appuyez sur < pour enregistrer et sortir.

**REMARQUE**

Si la température cible dépasse la valeur définie pour le **Seuil d'alarme**, la ligne de température **Max.** en haut à gauche de la vue en direct sera marquée en rouge.

6. (Facultatif) Appuyez sur  > **Paramètres de mesure de la température** > **Appairage de l'alarme** pour régler des alarmes sonores et/ou lumineuses.

**REMARQUE**

Appairage de l'alarme est un paramètre commun qui fonctionne pour toutes les alarmes déclenchées.

CHAPITRE 6 PARAMETRES D'AFFICHAGE

6.1 Réglage de la luminosité de l'écran

Allez à **Paramètres locaux > Paramètres d'affichage > Luminosité de l'écran** pour régler la luminosité de l'écran.

Vous pouvez également appuyer sur , puis le faire glisser pour régler la luminosité du menu déroulant.

6.2 Définir SuperIR

L'appareil prend en charge **SuperIR** sur la vue en direct (pour certains modèles) et sur les instantanés qui peuvent améliorer les contours des objets pour un meilleur affichage de l'image. L'effet réel dépend du produit particulier.

- ◆ Sur la vue en direct : Pour certains modèles, vous pouvez améliorer les contours des objets dans la vue en direct en activant SuperIR.
- ◆ Sur les images capturées : l'activation de SuperIR améliore les contours des objets de l'image.



REMARQUE

SuperIR est activé par défaut. Allez à **Paramètres locaux > Paramètres de capture > SuperIR** pour le désactiver.

6.3 Réglage du mode d'image

Définissez la vue de l'appareil que vous voulez utiliser entre thermique et optique. Vous avez le choix entre **Thermique, Fusion, PIP, Mixte** et **Optique**.

1. Touchez .
2. Appuyez sur les icônes pour sélectionner un mode d'image.

Mode d'image


Description




Exemple



Thermique

En mode Thermique, l'appareil affiche la vue Thermique.

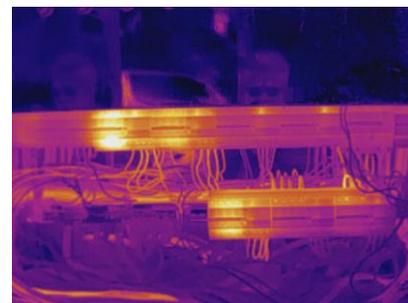

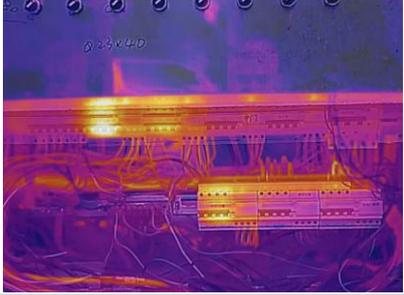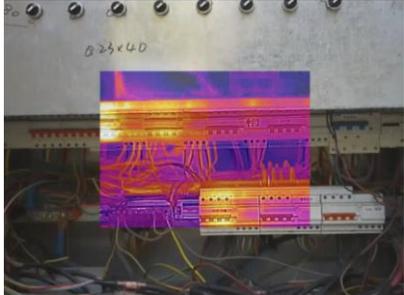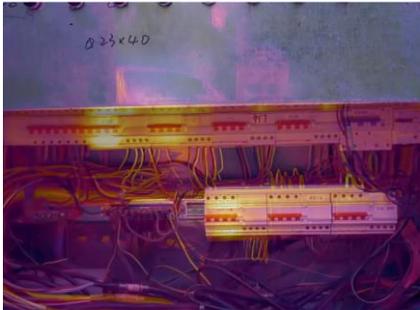Mode d'image	Description	Exemple
 Fusion	Image thermique de l'objet avec des contours visuels.	
 PIP	En mode PIP (incrustation d'image), l'appareil affiche la vue thermique à l'intérieur de la vue optique. Il est possible d'ajuster la taille et la distance de la fonction PIP.	
 Mixte	En mode Mixte, l'appareil affiche une vue mixte entre le canal thermique et le canal optique. Vous pouvez sélectionner le Niveau optique-thermique pour modifier le rapport optique-thermique.	
 Optique	Uniquement image visuelle de l'objet.	

3. Appuyez sur l'écran pour quitter.

6.4 Réglage du niveau et de la portée

Définissez une plage de température pour que la palette fonctionne seulement pour les cibles se situant dans cette plage. Vous pouvez régler la plage de température.

Avant de commencer

Choisissez une palette appropriée.

- ◆ Pour le modèle avec Mode scène, sélectionnez une scène et appuyez sur **Palettes** dans l'interface de configuration de scène pour choisir celui qui convient.

◆ Pour le modèle sans Mode scène, appuyez sur **MENU**, et sélectionnez  pour en obtenir un approprié.

1. Appuyez sur  dans la vue en direct.
2. Sélectionnez l'ajustement automatique  ou l'ajustement manuel .

	Automatique	Sélectionnez  . L'appareil ajuste automatiquement les paramètres d'affichage de la plage de température.
	Manuel	<ol style="list-style-type: none"> 1) Touchez une zone d'intérêt de l'écran. Un cercle s'affiche autour de la zone et la plage d'affichage de la température se réajuste pour afficher le plus de détails possible de la zone. 2) Appuyez sur la valeur min./max. de l'échelle de température pour verrouiller ou déverrouiller la valeur. 3) Faites défiler la molette de réglage sur l'écran pour affiner respectivement la température maximale et la température minimale. 4) Appuyez sur OK pour terminer.
 Remarque		Lorsque les températures min. et max. sont toutes deux déverrouillées, le défilement de la molette ajustera les températures min. et max. en même temps.

6.5 Réglage des informations affichées à l'écran

Appuyez sur , puis accédez à **Paramètres locaux > Paramètres d'affichage** pour activer ou désactiver l'affichage des informations à l'écran.

- ◆ **Heure et date** : Heure et date de l'appareil.
- ◆ **Paramètres** : Paramètres de mesure de la température, par exemple, émissivité cible.
- ◆ **Logo de marque** : Le logo de la marque est un logo de fabricant superposé sur les images.
- ◆ **Échelle de température** : Affichez la barre des palettes et la plage de température sur le côté droit de l'écran.

CHAPITRE 7 IMAGE ET VIDEO

REMARQUE

- ◆ L'appareil ne peut ni capturer ni enregistrer lorsque le menu est affiché.
- ◆ Lorsque l'appareil est connecté à votre ordinateur, il ne peut pas non plus ni capturer ni enregistrer.
- ◆ Appuyez sur  et accédez à **Paramètres locaux > Paramètres de l'appareil > Initialisation de l'appareil** pour initialiser le stockage si nécessaire.

7.1 Capturer une image

À partir de la vue en direct, appuyez sur  pour prendre un instantané. Activer la lampe torche à l'aide du menu déroulant dans un environnement sombre.

Vous pouvez également définir les paramètres suivants dans **Paramètres locaux > Paramètres de capture** si nécessaire.

Paramètres	Description
SuperIR	◆ Activez SuperIR avant la capture, afin d'améliorer les contours des objets des images capturées.
Enregistrer l'image optique	◆ Si vous devez enregistrer séparément une image optique, activez d'abord Enregistrer l'image optique .
Mode de capture	◆ Capture d'une image : Appuyez une fois sur  pour capturer une image. ◆ Capture planifiée : Définissez Intervalle (l'intervalle de temps de chaque instantané à prendre) et Nombre (le nombre d'instantanés à prendre dans un rouleau, allant de 1 à 10 000). Appuyez sur  dans la vue en direct, la caméra capture alors des images selon l'intervalle défini. Appuyez à nouveau sur  pour arrêter la capture.
En-tête de nom de fichier	Définissez la règle de nommage des fichiers enregistrés. Le nom par défaut de l'image correspond au <i>nom du fichier + l'heure d'enregistrement</i> . L' en-tête de nom de fichier est configurable. L'heure d'enregistrement correspond à l'heure système de l'appareil au moment de l'enregistrement.
Nommage du fichier	Les noms de fichier peuvent comporter un horodatage ou une numérotation (en-tête de nom de fichier + numéro de séquence).

REMARQUE

- ◆ Pour le mode **Capture d'une image**, l'image en direct se fige et est enregistrée dans l'album d'enregistrement par défaut.

- ◆ Pour le mode **Capture planifiée**, un compteur s'affiche dans la vue en direct pour indiquer le nombre de captures terminées.

Que faire ensuite

- ◆ Appuyez sur  pour accéder aux albums, puis afficher et gérer les fichiers et les albums. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation, reportez-vous à **7.3 Gestion des albums** et **7.5 Gestion des fichiers**.
- ◆ Vous pouvez connecter votre appareil au PC afin d'exporter des fichiers locaux dans des albums en vue d'une utilisation ultérieure. Reportez-vous à **7.6 Exportation des fichiers**.

7.2 Enregistrement d'une vidéo

Avant de commencer

Activer la lampe torche à l'aide du menu déroulant dans un environnement sombre.

1. (Facultatif) En mode vue en direct, appuyez sur , et aller à **Paramètres de capture > Enregistrer l'audio** pour activer/désactiver le son pendant l'enregistrement vidéo.
2. Dans l'interface de vue en direct, maintenez la touche de capture enfoncée pour démarrer un enregistrement. L'icône d'enregistrement et un compte à rebours s'affichent dans l'interface.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo enregistrée est automatiquement stockée.

7.3 Gestion des albums

Les fichiers image/vidéo enregistrés sont sauvegardés dans les albums. Vous pouvez créer de nouveaux albums, renommer un album, modifier l'album par défaut, déplacer des fichiers entre les albums et supprimer des albums.

Tâche	Opérations
Création d'un nouveau fichier	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur  pour entrer dans Albums. 2) Appuyez sur  pour ajouter un nouvel album. 3) Un clavier virtuel s'affiche pour saisir le nom de l'album. 4) Appuyez sur  pour terminer.
	<div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;">  REMARQUE L'album nouvellement créé devient l'album de sauvegarde par défaut et apparaît en haut de la liste des albums. </div>
Renommage d'un album	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur  pour entrer dans Albums. 2) Sélectionnez l'album à renommer. 3) Appuyez sur  et sélectionnez Renommer. Un clavier virtuel s'affiche. 4) Saisissez le nouveau nom avec le clavier virtuel. 5) Appuyez sur  pour terminer.

Tâche	Opérations
Changement de l'album de sauvegarde par défaut	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur  pour entrer dans Albums. 2) Sélectionnez l'album que vous voulez utiliser comme album de sauvegarde par défaut. 3) Appuyez sur  et sélectionnez Définir comme Album de sauvegarde par défaut. <div data-bbox="577 539 1430 611" style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p> REMARQUE L'album de sauvegarde par défaut apparaît en haut de la liste des albums.</p> </div>
Suppression d'un album	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur  pour entrer dans Albums. 2) Sélectionnez l'album que vous souhaitez supprimer. 3) Appuyez sur  et sélectionnez Supprimer. Une boîte de dialogue apparaît sur l'interface. 4) Appuyez sur OK pour supprimer l'album. <div data-bbox="577 882 1430 1090" style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p> REMARQUE Les fichiers d'un album sont également supprimés lors de la suppression de l'album. Déplacez les fichiers vers d'autres albums s'ils sont encore nécessaires. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à 7.5 Gestion des fichiers.</p> </div>

7.4 Affichage de fichiers

1. Appuyez sur  pour entrer dans **Albums**.
2. Appuyez pour sélectionner l'album dans lequel sont stockés les fichiers.
3. Appuyez pour sélectionner la vidéo ou l'instantané à afficher.
4. Affichez le fichier sélectionné et les informations pertinentes.

<p> REMARQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Les fichiers sont classés par ordre chronologique, les plus récents se trouvant en haut. Si vous ne parvenez pas à trouver les photos ou vidéos les plus récentes, vérifiez les paramètres d'heure et de date de votre appareil. Reportez-vous à 9.1 Configurer l'heure et la date pour les instructions. Lorsque vous visualisez des fichiers, vous pouvez passer à d'autres fichiers en appuyant sur < ou >. ◆ Pour accéder à plus d'informations contenues dans les instantanés ou les vidéos, installez le logiciel pour les analyser.
--	--

7.5 Gestion des fichiers

Vous pouvez déplacer, supprimer, modifier les fichiers et leur ajouter des notes de texte.

Tâche	Opérations
Suppression d'un fichier	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur  pour entrer dans Albums. 2) Appuyez pour sélectionner l'album de stockage du fichier à supprimer. 3) Dans l'album, appuyez pour afficher le fichier à supprimer. 4) Appuyez sur l'écran pour afficher la barre de menus ci-dessous, puis sur . Une boîte de dialogue apparaît sur l'interface. 5) Appuyez sur OK pour supprimer le fichier.
Suppression de plusieurs fichiers	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur  pour entrer dans Albums. 2) Appuyez pour sélectionner l'album de stockage des fichiers à supprimer. 3) Dans l'album, appuyez sur , puis appuyez sur les fichiers à supprimer. 4) Touchez . Une boîte de dialogue apparaît sur l'interface. 5) Appuyez sur OK pour supprimer les fichiers.
Déplacement d'un fichier	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur  pour entrer dans Albums. 2) Appuyez pour sélectionner l'album de stockage du fichier à déplacer. 3) Dans l'album, appuyez pour afficher le fichier à déplacer. 4) Appuyez sur le fichier pour afficher la barre de menus ci-dessous, puis sélectionnez . La liste des albums s'affiche. 5) Appuyez pour sélectionner l'album à déplacer.
Déplacement de plusieurs fichiers	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur  pour entrer dans Albums. 2) Appuyez pour sélectionner l'album de stockage des fichiers à déplacer. 3) Dans l'album, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers à déplacer. 4) Touchez . La liste des albums s'affiche. 5) Appuyez pour sélectionner l'album à déplacer.
Ajout d'une note de texte sur un fichier	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur  pour entrer dans Albums. 2) Appuyez pour sélectionner l'album de stockage des fichiers à modifier. 3) Dans l'album, appuyez pour afficher le fichier à modifier. 4) Appuyez sur l'écran pour afficher la barre de menus ci-dessous, puis sur . Un clavier virtuel s'affiche. 5) Saisissez la note de texte en touchant l'écran. 6) Appuyez sur  pour terminer.

Tâche**Opérations****Que faire ensuite**

Vous pouvez ouvrir la photo modifiée pour voir la note de texte.

**REMARQUE**

Vous pouvez appuyer sur / pour sélectionner/désélectionner tous les fichiers d'un album après avoir appuyé sur .

7.6 Exportation des fichiers

7.6.1 Exporter via HIKMICRO Viewer

1. Lancez HIKMICRO Viewer et ajoutez l'appareil. Reportez-vous au *Chapitre 8 Connexions de l'appareil*.
2. Sélectionnez **Fichiers sur l'appareil** sur l'application pour accéder aux albums sur l'appareil.
3. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **Télécharger** pour l'enregistrer sur vos albums locaux.

7.6.2 Exportation via l'ordinateur

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur via le câble USB fourni, puis sélectionnez le mode **Lecteur USB** comme mode USB dans l'invite sur l'appareil. En mode **Lecteur USB Drive**, l'écran de projection n'est pas pris en charge.
2. Ouvrez le disque détecté, copiez et collez les vidéos ou les instantanés sur l'ordinateur pour afficher les fichiers.
3. Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.

**REMARQUE**

Lors de la première connexion, le pilote est installé automatiquement.

CHAPITRE 8 CONNEXIONS DE L'APPAREIL

Lorsque l'appareil est connecté à certaines applications ou logiciels clients sur votre téléphone mobile ou votre ordinateur, vous pouvez parcourir l'image en temps réel dans la caméra, enregistrer des vidéos et capturer des instantanés via des téléphones ou des ordinateurs.

8.1 Diffuser l'écran de l'appareil sur l'ordinateur

L'appareil prend en charge la diffusion d'écran sur PC par HIKMICRO Analyzer, un logiciel client basé sur le protocole UVC. Vous pouvez diffuser la vue en direct de l'appareil sur votre PC, prendre des instantanés et enregistrer des vidéos via le client.

Veuillez visiter notre site Web www.hikmicrotech.com ou contactez nos supports techniques ou nos équipes de service client pour les packages d'installation, et téléchargez et installez HIKMICRO Analyzer.

Consultez le manuel d'utilisation du client HIKMICRO Analyzer pour une connexion spécifique et plus d'opérations.

8.2 Connectez l'appareil à HIKMICRO Viewer

Connectez l'appareil à HIKMICRO Viewer via un point d'accès ou Wi-Fi, et les utilisateurs peuvent visualiser des images, capturer des instantanés et enregistrer des vidéos sur des téléphones mobiles.

8.2.1 Connexion via Wi-Fi

Avant de commencer

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application HIKMICRO Viewer sur votre téléphone.



Android




iOS

REMARQUE

- ◆ Ne saisissez PAS d'espace dans votre mot de passe, sinon il risque d'être incorrect.
- ◆ Appuyez sur  pour saisir le mot de passe dans le champ prévu à cet effet.

1. Connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi.
 - 1) En mode vue en direct, appuyez sur  et allez à **Connexions > WLAN**.
 - 2) Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
 - 3) Sélectionnez le Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Un clavier virtuel s'affiche.
 - 4) Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.
2. Ajoutez l'appareil à HIKMICRO Viewer.
 - ◆ Utilisation du mot de passe Wi-Fi.
 - 1) Sélectionnez le même réseau Wi-Fi auquel est connecté l'appareil sur votre téléphone, entrez le mot de passe et rejoignez-le.
 - 2) Lancez HIKMICRO Viewer.
 - 3) Appuyez sur **+** > **Ajout de l'appareil** > **Connecter** pour ajouter l'appareil.
 - ◆ Génération du code QR pour le Wi-Fi.
 - 1) Appuyez sur  en regard du réseau Wi-Fi rejoint sur l'appareil pour afficher le code QR du Wi-Fi.
 - 2) Lancez HIKMICRO Viewer.
 - 3) Appuyez sur **+** > **Lecture du code QR** pour diriger le cadre de numérisation vers le code.
 - 4) Appuyez sur **Rejoindre** dans la fenêtre contextuelle sur votre téléphone pour confirmer les paramètres.

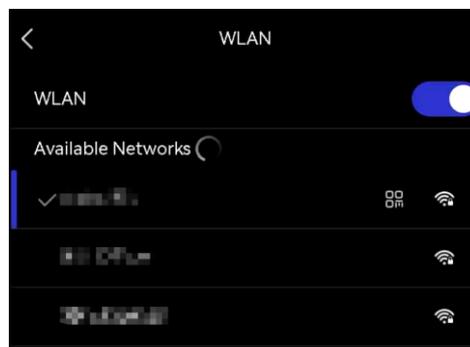

8.2.2 Connexion via point d'accès

Avant de commencer

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application HIKMICRO Viewer sur votre téléphone.



Android



iOS

1. En mode vue en direct, appuyez sur  et allez à **Connexions > Point d'accès**.
2. Appuyez sur  pour activer la fonction de point d'accès. Le nom du point d'accès est constitué des 9 derniers chiffres du numéro de série de l'appareil.
3. Définissez le point d'accès de l'appareil et rejoignez-le avec votre téléphone.
 - ◆ **Utilisation d'un mot de passe pour le point d'accès :**
 - 1) Appuyez sur **Définir mot de passe**. Un clavier virtuel s'affiche.
 - 2) Définissez le mot de passe pour le point d'accès en touchant l'écran.
 - 3) Appuyez sur  pour terminer.
 - 4) Activez la fonction Wi-Fi de votre téléphone et recherchez le point d'accès de l'appareil pour vous y connecter.
 - ◆ **Utilisation d'un code QR pour le point d'accès :**
 - 1) Lancez HIKMICRO Viewer, puis appuyez sur **+ > Scanner le code QR**.
 - 2) Visez la caméra du téléphone vers le code QR du point d'accès de l'appareil.
 - 3) Appuyez sur **Rejoindre > Connecter** dans la fenêtre contextuelle sur votre téléphone pour confirmer les paramètres.

**REMARQUE**

- ◆ Ne saisissez PAS d'espace dans votre mot de passe, sinon il risque d'être incorrect.
- ◆ Le mot de passe doit contenir au moins 8 chiffres, composés de chiffres et de caractères.
- ◆ Appuyez sur  pour saisir le mot de passe dans le champ prévu à cet effet.

CHAPITRE 9 PARAMETRES SYSTEME

9.1 Configurer l'heure et la date

1. Accédez à **Paramètres locaux > Paramètres de l'appareil > Heure et date**.
2. Réglez la date et l'heure.
3. Appuyez sur < pour enregistrer et sortir des réglages.



REMARQUE

Allez à **Paramètres locaux > Paramètres d'affichage** pour activer ou désactiver l'affichage de la date et de l'heure.

9.2 Définir les unités de mesure

Accédez à **Paramètres locaux > Paramètres d'affichage > Unité** pour définir l'unité de température et l'unité de distance.

9.3 Réglage de la langue

Accédez à **Paramètres locaux > Paramètres de l'appareil > Langue** pour sélectionner une langue requise.

CHAPITRE 10 MAINTENANCE

10.1 Affichage des informations sur l'appareil

Accédez à **Paramètres locaux > Paramètres de l'appareil > À propos** pour afficher les informations sur l'appareil.

10.2 Mise à niveau de l'appareil

10.2.1 Mettre à niveau l'appareil via le fichier de mise à niveau

Avant de commencer

Pour obtenir tout d'abord le fichier de mise à niveau, téléchargez-le sur le site Web officiel <http://www.hikmicrotech.com> ou contactez le service clientèle et l'assistance technique.

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur via le câble USB fourni, puis sélectionnez le mode **Lecteur USB** comme mode USB dans l'invite sur l'appareil.
2. Décompressez le fichier de mise à niveau et copiez-le dans le répertoire racine de l'appareil.
3. Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.
4. Redémarrez l'appareil et il se mettra automatiquement à niveau. Le processus de mise à niveau sera affiché dans l'interface principale.



REMARQUE

Après la mise à niveau, l'appareil redémarre automatiquement. Vous pouvez consulter la version actuelle dans **Paramètres locaux > Paramètres de l'appareil > À propos**.

10.2.2 Mise à niveau de l'appareil à l'aide de HIKMICRO Viewer

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir installé HIKMICRO Viewer sur votre téléphone. Veuillez consulter **8.2 Connectez l'appareil à HIKMICRO Viewer** pour les instructions.

1. Démarrez HIKMICRO Viewer sur votre téléphone.
2. Mettre à jour l'appareil. Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :
 - ◆ Sur l'écran d'accueil, Appuyez sur **Mise à jour de l'appareil > Vérifier les mises à jour**.
 - ◆ Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Informations sur l'appareil > Mise à jour de l'appareil > Vérifier les mises à jour**.

10.3 Restaurer l'appareil

Accédez à **Paramètres de l'appareil > Initialisation de l'appareil > Restaurer l'appareil** pour initialiser l'appareil et restaurer les paramètres par défaut.

10.4 Enregistrer les journaux des opérations

L'appareil peut collecter ses journaux des opérations et les enregistrer dans le stockage à des fins de dépannage uniquement. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction dans **Paramètres locaux > Paramètres de l'appareil > Enregistrer les journaux**.

Vous pouvez connecter la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, puis sélectionner **Lecteur USB** comme mode USB sur la caméra pour exporter les journaux des opérations (fichiers .log) dans le répertoire racine de la caméra, si nécessaire.

10.5 Initialisation du stockage

Accédez à **Paramètres de l'appareil > Initialisation de l'appareil > Formater le stockage** pour initialiser le stockage.



Mise en garde

Si le stockage contient des fichiers, assurez-vous qu'ils ont été sauvegardés avant le formatage. Une fois le stockage initialisé, les données et les fichiers sont irrécupérables.

10.6 À propos de l'étalonnage

Veillez contacter le revendeur local pour obtenir des informations sur les points d'entretien. Pour des services d'étalonnage plus détaillés, veuillez visiter le site <https://www.hikmicrotech.com/en/support>.

CHAPITRE 11 QUESTIONS FREQUENTES

Scannez le code QR suivant pour accéder à la foire aux questions de l'appareil.



INFORMATIONS LEGALES

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Tous droits réservés.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Web de HIKMICRO (<http://www.hikmicrotech.com>).

Veuillez utiliser ce mode d'emploi avec les conseils et l'assistance de professionnels spécialement formés dans la prise en charge de ce produit.

Marques déposées



HIKMICRO et les autres marques commerciales et logos de HIKMICRO sont la propriété de HIKMICRO dans diverses juridictions.

Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Clause d'exclusion de responsabilité

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT MANUEL ET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SES MICROLOGICIELS, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC CES DÉFAUTS ET ERREURS ». HIKMICRO NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS, HIKMICRO NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU INDIRECT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE PROFITS D'ENTREPRISE, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, OU LA PERTE DES DONNÉES, LA CORRUPTION DES SYSTÈMES, OU LA PERTE DES DOCUMENTS, S'ILS SONT BASÉS SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UNE FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS, OU AUTRE, EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKMICRO A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE TELLE PERTE.

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKMICRO SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTION PAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET ; TOUTEFOIS, HIKMICRO FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE

DANS LES DÉLAIS SI NÉCESSAIRE.

VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOIS EN VIGUEUR. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CE QUE VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME À LA LOI APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT SURTOUT D'UTILISER CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D'AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT OU LA PRODUCTION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE LIÉ AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Ces clauses ne s'appliquent qu'aux produits portant la marque ou l'information correspondante.

Déclaration de conformité UE



Ce produit et, le cas échéant, les accessoires qui l'accompagnent, sont estampillés « CE » et sont donc conformes aux normes européennes harmonisées en vigueur répertoriées sous la directive 2014/30/UE (EMCD), la directive 2014/35/UE (LVD) et la directive 2011/65/UE (RoHS).

Par la présente, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. déclare que cet appareil (se référer à l'étiquette) est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité du texte de la Déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-comformity/>.

Restrictions relatives à la bande 5 GHz :

Conformément à l'Article 10 (10) de la Directive 2014/53/UE, lorsque cet appareil fonctionne sur la plage de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz, son utilisation est restreinte à une utilisation en intérieur dans les pays suivants : Autriche (AT), Belgique (BE), Bulgarie (BG), Croatie (HR), Chypre (CY), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EE), Finlande (FI), France (FR), Allemagne (DE), Grèce (EL), Hongrie (HU), Islande (IS), Irlande (IE), Italie (IT), Lettonie (LV), Liechtenstein (LI), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Irlande du Nord (UK(NI)), Norvège (NO), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Espagne (ES), Suède (SE), Suisse (CH) et Turquie (TR).

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été testé et respecte les limites applicables à l'exposition aux radiofréquences (RF).

Bandes de fréquence et puissance (pour la CE)

Les bandes et modes de fréquences et les limites nominales de puissance d'émission (rayonnée ou induite) applicables aux équipements radio suivants sont les suivantes :

Wi-Fi : 2,4 GHz (2,4 GHz à 2,4835 GHz) : 20 dBm. 5 GHz (5,15 GHz à 5,25 GHz) : 23 dBm. 5 GHz (5,25 GHz à 5,35 GHz) : 23 dBm. 5 GHz (5,47 GHz à 5,725 GHz) : 23 dBm. 5 GHz (5,725 GHz à 5,875 GHz) : 14 dBm

Pour les appareils sans adaptateur d'alimentation offert, utilisez

l'adaptateur d'alimentation fourni par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en matière d'alimentation.

Pour les appareils sans batterie offerte, utilisez la batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les détails concernant la pile.



Directive 2012/19/UE (directive DEEE) : dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, rendez-vous sur : www.recyclethis.info.



Règlement (UE) 2023/1542 (Règlement sur les piles/batteries) : Ce produit contient une batterie et est conforme au règlement (UE) 2023/1542. Les

La batterie ne peut pas être déposée dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué, dans l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la pile, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte ce symbole qui peut inclure la mention cadmium (Cd) ou plomb (Pb). Pour la recycler correctement, renvoyez-la à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, rendez-vous sur : www.recyclethis.info.

Conformité Industrie Canada ICES-003

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements, CNR-102 énoncée dans un autre environnement.

- (i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
- (ii) Le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doivent respecter le pire limiter; et
- (iii) Le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans la bande 5725-5875 MHz doivent respecter le pire limites spécifiées pour le point-à-point et l'exploitation non point à point, le cas échéant.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d.,

qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.



See the World in a New Way

 Hikmicro industriel

 support@hikmicrotech.com

 HIKMICRO Industrial

 hikmicro_industriel

 HIKMICRO

 <https://www.hikmicrotech.com/>